
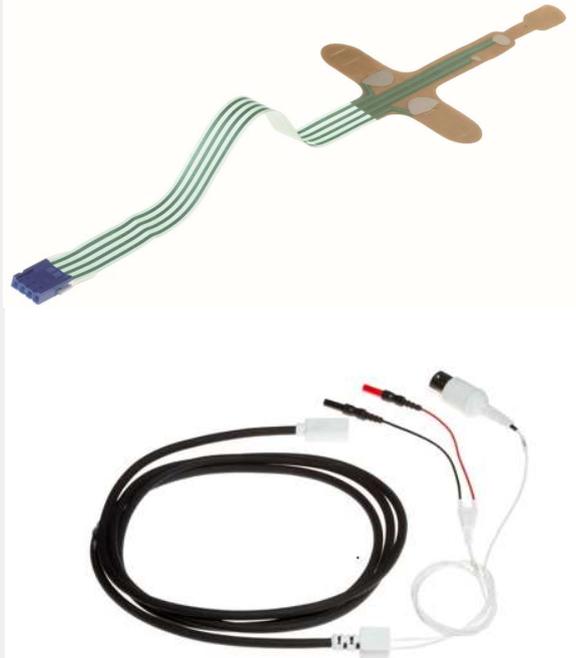


陰部神経電極 PUD0001

Pudendal electrode

- 陰部神経、骨盤底筋での誘発筋電図検査用のディスポ電極です。
- 手袋に貼り付けて使用します。

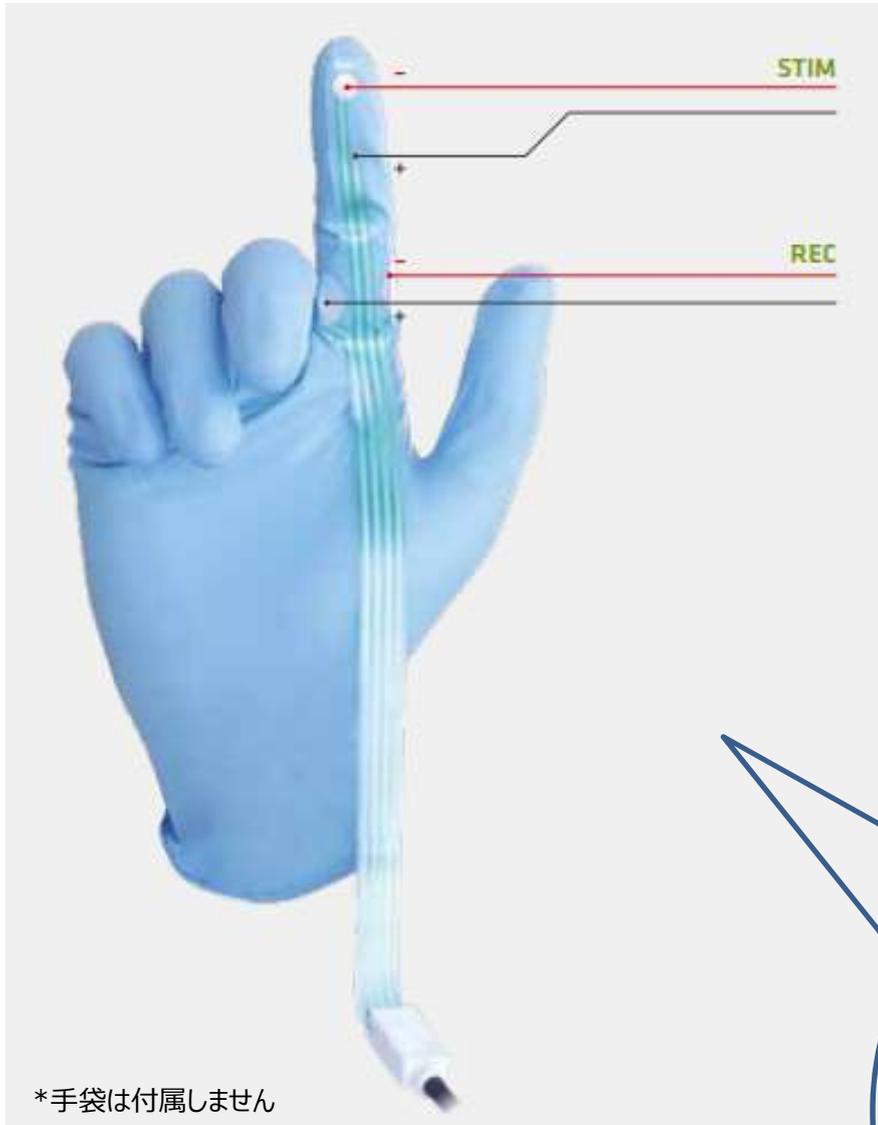

*手袋は付属しません

接続ケーブル

リード長: 200cm

記録側コネクタ: 5 pole din

刺激側コネクタ: 5 pole din または 1,5 mm din



弊社取扱製品の誘発筋電計「Neuro-MEP-micro」と併用できます。
(製造販売届出番号229ADBZX00012000)

お問い合わせ イーストメディック株式会社

本社 〒920-0062 石川県金沢市割出町702-2
TEL:076-239-4761 / FAX:076-239-1771
URL: <http://www.east-medica.jp>

製造元 Spes Medica S. r. l.,

Via Europa Zona Industriale, 84091 Battipaglia (Sa), Italy

